

**ESE METROSALUD**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ANEXO 6 ESPECIFICACIONES TECNICAS ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LA RED METROSALUD**

ELEMENTO SOLICITADO	CARACTERISTICAS TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	IMAGEN
<b>MASCARILLA O CUBRE BOCA PLISADO ALTA EFICIENCIA N95</b>	CAPA INFERIOR EN POLIPROPILENO Y POLIESTER, CAPA INTERMEDIA FILTRO AMORTIGUADOR, MELT BLOWN - ANTIBACTERIAL, FILTRO EXTERNO NO TEJIDO POLIPROPILENO BARRERA CONTRA PARTICULAS	x			
	EFICACIA DE FILTRACION DEL MATERIAL FILTRANTE ≥ 95%	x			
	PUEDA SER DE DIVERSAS TALLAS, EN CUALQUIER CASO DEBEN TENER DIMENSIONES QUE CUBRAN PERFECTAMENTE LAS ENTRADAS A LAS VIAS RESPIRATORIAS	x			
	CUNTAS ELASTICAS: LATEX EN ULE NATURAL, CLIP NASAL DE ALUMINIO PARA UN MEJOR SELLO		x	tiras elasticas a las orejas, impide el buen sellamiento, se desprenden con facilidad los elasticos	
	APROBADO PARA MATERIAL PARTICULADO, NORMA 42 CFR 84, NIOSH (N95) Y LA NORMA NTC 2561 (TIPO B))		x		
	CONTAR CON REGISTRO SANITARIO O AUTORIZACION POR PARTE DEL INVIMA RESOL 522 DE 2020		x	No esta en las alertas del invima	
	CERTIFICADO NIOSH, FFP2 O FFP3 (EN 149)		x	No se encuentra	
	SOPORTE METALICO NASAL RECUBIERTO CON PLASTICO MOLDEABLE QUE GARANTICE AJUSTE	x			
	COLOR AZUL O BLANCA	x			
	INOLORO	x			
ANTIALERGICO		x	No especifica		
RESISTENTE A LA HUMEDAD	x				
REGISTRO SANITARIO O AUTORIZACION POR PARTE DEL INVIMA RESOLUCION 522 DE 2020 Y / VISTO BUENO DE IMPORTACION		x	No se tiene y no se encuentra		

No alerta sanitaria

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
 Gobernacion Donacion

05/08/2020

FIRMA:

*Amir Gutierrez*  
*Miguel Ángel Valle*  
*Katherine Cecilia Cedeño*

**ESE METROSALUD**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ANEXO 6 ESPECIFICACIONES TECNICAS ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LA RED METROSALUD**

ELEMENTO SOLICITADO	CARACTERISTICAS TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	IMAGEN
<b>MASCARILLA O CUBRE BOCA PLISADO (PLIEGUES), DESCARTABLE CON ELÁSTICO.</b>	MASCARILLA DE 3 CAPAS	X			
	DOS CAPAS DE SPUNBOND EN MATERIAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO (interna y externa)	X			
	UNA CAPA CENTRAL DE MELTBLOWM (Eficacia de filtración del material filtrante del ≥ 94%)	X			
	ELABORADA CON MINIMO TRES PLIEGUES	X			
	LAS MASCARILLAS PUEDEN SER DE DIVERSAS TALLAS, PERO EN CUALQUIER CASO DEBEN TENER DIMENSIONES QUE CUBRAN PERFECTAMENTE LAS ENTRADAS A LAS VÍAS RESPIRATORIAS.	X			
	TERMOSELLADA	X			
	SUJECION ELASTICA A LA OREJA	X			
	SOPORTE METÁLICO NASAL RECUBIERTO CON PLÁSTICO MOLDEABLE	X			
	COLOR AZUL O BLANCA	X			
	SIN OLOR	X			
	HIPOALERGENICO	X			
	LIBRE DE LATEX Y FIBRA DE VIDRIO	X			
REGISTRO SANITARIO O AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL INVIMA RESOLUCIÓN 522 DE 2020 Y / VISTO BUENO DE IMPORTACION	X		Tiene registro invima N 2019DM-0003853-R1		

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
Rymco

05/08/2020

FIRMA:

*Amir Gutierrez*  
*Miguel Ángel Valle*  
*Katherine Cecilia Sudest*

**ESE METROSALUD**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ANEXO 6 ESPECIFICACIONES TECNICAS ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LA RED METROSALUD**

ELEMENTO SOLICITADO	CARACTERISTICAS TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	IMAGEN
<b>MASCARILLA O CUBRE BOCA PLISADO (PLIEGUES), DESCARTABLE CON ELÁSTICO.</b>	MASCARILLA DE 3 CAPAS	x			
	DOS CAPAS DE SPUNBOND EN MATERIAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO (interna y externa)	x			
	UNA CAPA CENTRAL DE MELTBLOWM (Eficacia de filtración del material filtrante del ≥ 94%)	x			
	ELABORADA CON MINIMO TRES PLIEGUES	x			
	LAS MASCARILLAS PUEDEN SER DE DIVERSAS TALLAS, PERO EN CUALQUIER CASO DEBEN TENER DIMENSIONES QUE CUBRAN PERFECTAMENTE LAS ENTRADAS A LAS VÍAS RESPIRATORIAS.	x			
	TERMOSELLADA	x			
	SUJECION ELASTICA A LA OREJA	x		Se despega con facilidad	
	SOPORTE METÁLICO NASAL RECUBIERTO CON PLÁSTICO MOLDEABLE	x			
	COLOR AZUL O BLANCA	x			
	SIN OLOR	x			
	HIPOALERGENICO				
	LIBRE DE LATEX Y FIBRA DE VIDRIO				
REGISTRO SANITARIO O AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL INVIMA RESOLUCIÓN 522 DE 2020 Y / VISTO BUENO DE IMPORTACION					

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
Mascarilla quirurgica Positiva

05/08/2020

FIRMA:

*auricats*  
*Miguel Ángel Valle*  
*Katherine Cuello Cordeiro*

ESE METROSALUD  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ANEXO 6 ESPECIFICACIONES TECNICAS ELEMENTOS DE DOTACION

ELEMENTO SOLICITADO	CARACTERISTICAS TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	IMAGEN
<b>BATA MANGA LARGA DESECHABLE</b>	En tela anifluidos desechable	x		<b>Enresortado, no puño de algodón</b>  <b>amarre trasero</b>  <b>debajo de la pantorrilla</b>	
	Manga larga con puño 100% poliéster elaborada en maquina reclineo de fondo entero. indispensable buen ajuste a la muñeca.	x			
	Cuello redondo con sesgo que termina en tiras de amarre en cuello.	x			
	Tiras laterales de amarre en la cintura lateral de 130 cms c/u ( ver imagen )	x			
	Largo total de las batas por debajo de la pantorrilla	x			
	Talla única (norma EN-13795) perímetro de la bata 125 cms	x			

La evaluación incluye el kit de salud oral, no se usan polainas en la ESE Metrosalud.

NUMBRE D'LL REPRESENTANTE LEGAL:

Donacion ARL Sura

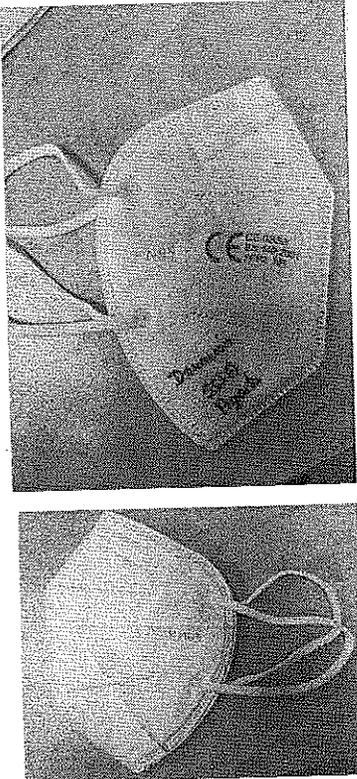
05/08/2020

INDUSTRIAS CATNAT

FIRMA:

*Aurora Gutierrez*  
*Mónica Aguilar Valle*  
*Katherine Celso Cedeno*

**ESE METROSALUD**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ANEXO 6 ESPECIFICACIONES TECNICAS ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LA RED METROSALUD**

ELEMENTO SOLICITADO	CARACTERISTICAS TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	IMAGEN	
<b>MASCARILLA O CUBRE BOCA PLISADO ALTA EFICIENCIA N95</b>	CAPA INFERIOR EN POLIPROPILENO Y POLIESTER, CAPA INTERMEDIA FILTRO AMORTIGUADOR, MELT BLOWN - ANTIBACTERIAL, FILTRO EXTERNO NO TEJIDO POLIPROPILENO BARRERA CONTRA PARTICULAS	x				
	EFICACIA DE FILTRACION DEL MATERIAL FILTRANTE ≥ 95%	x				
	PUEDE SER DE DIVERSAS TALLAS, EN CUALQUIER CASO DEBEN TENER DIMENSIONES QUE CUBRAN PERFECTAMENTE LAS ENTRADAS A LAS VIAS RESPIRATORIAS	x				
	CUNTAS ELASTICAS: LATEX EN ULE NATURAL, CLIP NASAL DE ALUMINIO PARA UN MEJOR SELLO			x		tiras elasticas a las orejas, impide el buen sellamiento, se desprenden con facilidad los elasticos
	APROBADO PARA MATERIAL PARTICULADO, NORMA 42 CFR 84, NIOSH (N95) Y LA NORMA NTC 2561 (TIPO B)			x		
	CONTAR CON REGISTRO SANITARIO O AUTORIZACION POR PARTE DEL INVIMA RESOL 522 DE 2020	x		x		No esta en las alertas del invima
	CERTIFICADO NIOSH, FFP2 O FFP3 (EN 149)			x		No se encuentra
	SOPORTE METÁLICO NASAL RECUBIERTO CON PLÁSTICO MOLDEABLE QUE GARANTICE AJUSTE	x				
	COLOR, AZUL O BLANCA	x				
	INOLORO	x				
	ANTIALERGICO			x		No especifica
	RESISTENTE A LA HUMEDAD	x				
	REGISTRO SANITARIO O AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL INVIMA RESOLUCIÓN 522 DE 2020 Y / VISTO BUENO DE IMPORTACION			x		No se tiene y no se encuentra

No se puede buscar en alerta sanitaria porque no se conoce el proveedor, ni el fabricante, sin ficha técnica

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:**  
 Gobernacion Donacion

**FIRMA:**

*Anna Goby*

KN95 CE 0553 EN 149:2001 FFP2 NR

05/08/2020

*Miguel Ángel Valle*  
*Katherine Cuello Indurá*

**ESE METROSALUD**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ANEXO 6 ESPECIFICACIONES TECNICAS ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LA RED METROSALUD**

ELEMENTO SOLICITADO	CARACTERISTICAS TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	IMAGEN
<b>MASCARILLA O CUBRE BOCA PLISADO ALTA EFICIENCIA N95</b>	CAPA INFERIOR EN POLIPROPILENO Y POLIESTER, CAPA INTERMEDIA FILTRO AMORTIGUADOR, MELT BLOUN - ANTIBACTERIAL, FILTRO EXTERNO NO TEJIDO POLIPROPILENO BARRERA CONTRA PARTICULAS		x	Solo tres capas, no tiene capa de filtro amortiguador	
	EFICACIA DE FILTRACION DEL MATERIAL FILTRANTE ≥ 95%	x			
	PUEDE SER DE DIVERSAS TALLAS, EN CUALQUIER CASO DEBEN TENER DIMENSIONES QUE CUBRAN PERFECTAMENTE LAS ENTRADAS A LAS VIAS RESPIRATORIAS	x			
	CUNTAS ELASTICAS: LATEX EN ULE NATURAL, CLIP NASAL DE ALUMINIO PARA UN MEJOR SELLO		x	tiras elasticas a las orejas, impide el buen sellamiento, se desprenden con facilidad los elasticos	
	APROBADO PARA MATERIAL PARTICULADO, NORMA 42 CFR 84, NIOSH (N95) Y LA NORMA NTC 2561 (TIPO B))		x		
	CONTAR CON REGISTRO SANITARIO O AUTORIZACION POR PARTE DEL INVIMA RESOL 522 DE 2020			No esta en las alertas del invima	
	CERTIFICADO NIOSH, FFP2 O FFP3 (EN 149)		x		
	SOPORTE METÁLICO NASAL RECUBIERTO CON PLÁSTICO MOLDEABLE QUE GARANTICE AJUSTE	x			
	COLOR AZUL O BLANCA	x			
	INOLORO	x			
ANTIALERGICO	x				
RESISTENTE A LA HUMEDAD	x				
REGISTRO SANITARIO O AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL INVIMA RESOLUCIÓN 522 DE 2020 Y / VISTO BUENO DE IMPORTACION		x	No se tiene y no se encuentra		

No alerta sanitaria

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Dr. Elson KN95

05/08/2020

FIRMA:

*Anna Gutierrez*  
*Miguel Ángel Vela*  
*Katherine Cuello Cadevall*

**ESE METROSALUD**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ANEXO 6 ESPECIFICACIONES TECNICAS ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LA RED METROS**

ELEMENTO SOLICITADO	CARACTERISTICAS TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<b>MASCARILLA O CUBRE BOCA PLISADO (PLIEGUES), DESCARTABLE CON ELÁSTICO.</b>	MASCARILLA DE 3 CAPAS	X		
	DOS CAPAS DE SPUNBOND EN MATERIAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO (interna y externa)	X		
	UNA CAPA CENTRAL DE MELTBLOWM (Eficacia de filtración del material filtrante del $\geq 94\%$ )		x	capa muy delgada
	ELABORADA CON MINIMO TRES PLIEGUES	X		
	LAS MASCARILLAS PUEDEN SER DE DIVERSAS TALLAS, PERO EN CUALQUIER CASO DEBEN TENER DIMENSIONES QUE CUBRAN PERFECTAMENTE LAS ENTRADAS A LAS VÍAS RESPIRATORIAS.	X		
	TERMOSELLADA	X		
	SUJECION ELASTICA A LA OREJA		x	elastico que se desprende fácilmente
	SOPORTE METÁLICO NASAL RECUBIERTO CON PLÁSTICO MOLDEABLE	X		
	COLOR AZUL O BLANCA	X		
	SIN OLOR	X		
	HIPOALERGENICO			no se conoce ficha técnica de material
	LIBRE DE LATEX Y FIBRA DE VIDRIO			no se conoce ficha técnica de material
	REGISTRO SANITARIO O AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL INVIMA RESOLUCIÓN 522 DE 2020 Y / VISTO BUENO DE IMPORTACION			x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
 Maxter-Rossini Company SAS

05/08/2020

FIRMA:



*Manuel Jacobo Roldán*

ESE METROSALUD  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ANEXO 6 ESPECIFICACIONES TECNICAS ELEMENTOS DE DOTACION

ELEMENTO SOLICITADO	CARACTERISTICAS TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	IMAGEN
<b>BATA MANGA LARGA DESECHABLE</b>	En tela antifluidos desechable	x		<b>Enresortado, no puño de algodón</b>  <b>amarre trasero</b>  <b>debajo de la pantorrilla</b>	
	Manga larga con puño 100% poliéster elaborada en maquina rectilineo de fondo entero, indispensable buen ajuste a la muñeca.	x			
	Cuello redondo con sesgo que termina en tiras de amarre en cuello	x			
	Tiras laterales de amarre en la cintura lateral de 130 cms c/u ( ver imagen )	x			
	Largo total de las batas por debajo de la pantorrilla	x			
	Talla única (norma EN-13795) perímetro de la bata 125 cms	x			

La evaluacion incluye el kit de salud oral, no se usan polainas en la ESE Metrosalud.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Donacion ARL Sura

05/08/2020

INDUSTRIAS CATNAT

FIRMA:

*Allegu*

*Miguel Ángel Vello*

*Katherine Cecilia Ledwith*

ESE METROSALUD  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ANEXO 6 ESPECIFICACIONES TECNICAS ELEMENTOS DE DOTACION

ELEMENTO SOLICITADO	CARACTERISTICAS TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	IMAGEN	
<b>BATA MANGA LARGA DESECHABLE</b>	En tela antifluidos desechable	x		<b>Enresortado, no puño de algodón</b>		
	Manga larga con puño 100% poliéster elaborada en maquina rectilineo de fondo entero, indispensable buen ajuste a la muñeca.	x				
	Cuello redondo con sesgo que termina en tiras de amarre en cuello	x				
	Tiras laterales de amarre en la cintura lateral de 130 cms c/u ( ver imagen )	x				<b>amarre trasero</b>
	Largo total de las batas por debajo de la pantorrilla		x			<b>llega a la rodilla</b>
	Talla única (norma EN-13795) perímetro de la bata 125 cms	x				

La bata es de tela desechable color azul, su largo es hasta la rodilla, el puño es enresortado, no con puño en algodón

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
Donacion Gobernacion de Antioquia  
05/08/2020  
CEPILAB

FIRMA:

*Amir Goto*  
*Miguel Ángel Saldaña*  
*Katharina Cuello Ladeoff*

**ESE METROSALUD**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ANEXO 6 ESPECIFICACIONES TECNICAS ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LA RED METROSALUD**

ELEMENTO SOLICITADO	CARACTERISTICAS TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	IMAGEN
<b>MASCARILLA O CUBRE BOCA PLISADO ALTA EFICIENCIA N95</b>	CAPA INFERIOR EN POLIPROPILENO Y POLIESTER, CAPA INTERMEDIA FILTRO AMORTIGUADOR, MELT BLOWN - ANTIBACTERIAL, FILTRO EXTERNO NO TEJIDO POLIPROPILENO BARRERA CONTRA PARTICULAS	X			 <p>Respirador NIOSH N95-9510-1 Blanco</p>
	EFICACIA DE FILTRACIÓN DEL MATERIAL FILTRANTE ≥ 95%	X			
	PUEDE SER DE DIVERSAS TALLAS, EN CUALQUIER CASO DEBEN TENER DIMENSIONES QUE CUBRAN PERFECTAMENTE LAS ENTRADAS A LAS VIAS RESPIRATORIAS	X			
	CUNTAS ELASTICAS: LATEX EN ULE NATURAL, CLIP NASAL DE ALUMINIO PARA UN MEJOR SELLO	X			
	APROBADO PARA MATERIAL PARTICULADO, NORMA 42 CFR 84, NIOSH (N95) Y LA NORMA NTC 2561 (TIPO B)	X			
	CONTAR CON REGISTRO SANITARIO O AUTORIZACION POR PARTE DEL INVIMA RESOL 522 DE 2020	X			
	CERTIFICADO NIOSH, FFP2 O FFP3 (EN 149)	X			
	SOPORTE METÁLICO NASAL RECUBIERTO CON PLÁSTICO MOLDEABLE QUE GARANTICE AJUSTE	X			
	COLOR AZUL O BLANCA	X			
	INOLORO	X			
	ANTIALERGICO	X			
	RESISTENTE A LA HUMEDAD	X			
	REGISTRO SANITARIO O AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL INVIMA RESOLUCIÓN 522 DE 2020 Y / VISTO BUENO DE IMPORTACION	X			

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:**

Donación ARL Positiva

Marca NITTA

05/08/2020

**FIRMA:**

*Anna Gutzy*

*Miguel Ángel Valle  
Katherine Cello Inchausti*

Código:	PE02 FR 331	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS</b>	 Metrosalud
Versión:	01		
Vigente a partir de:	27/07/2020		
Página:	4 de 12		

Tipo: Medicamento  Dispositivo médico  Equipo biomédico

Proveedor: **Creativos** Molmo da

Nombre de la Tecnología a evaluar: Bata manga larga antifluidos

Fecha de la Evaluación: 05 agosto 2020

Ítem a Evaluar	Calificación *
Caracterizar la tecnología técnicamente: Especificaciones técnicas que la nueva tecnología debe cumplir al momento de la adquisición	Cumple
Pruebas técnicas que se hacen sobre las tecnologías nuevas: Calibración, pruebas de calidad entre otras (si son requeridas)	No Aplica
Calidad: Registro sanitario, permisos, certificaciones y otros	Cumple
Especificaciones: Lo que debe ser obligatorio, condiciones de la empresa, normatividad que lo rige	Cumple
Uso seguro: Validar los aspectos que debe garantizar para el usuario interno y externo	Cumple
Tiempos de garantía: En los casos que aplique	Cumple

\*Calificación: Cumple, No Cumple, No Aplica.

Concepto final:

Batas cumplen las especificaciones técnicas definidas, evaluar si el puño lo pueden colocar como lo define el ministerio en algodón, la ficha técnica adjunta de la tela es Lafayette, la indicada para garantizar antifluido, pendiente evaluar el ultimo item una vez se tenga la prenda producida.

Observaciones:

Responsable de la evaluación	Aprobación de la solicitud
Firma:   	Firma:
Nombre: Aura Gutiérrez Martínez Marcela Arrubla Villa Catherine Cuello Ladeutt	Nombre:
Cargo: Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado Epidemiología Profesional Especializado Salud Ocupacional	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional. Cargo: Subgerente red de servicios
Fecha: 05 agosto 2020	Fecha:
Adjuntar: Ficha técnica, certificados, permisos, Registros INVIMA o del ente regulador, soportes de la tecnología necesarios en la evaluación realizada	